


Algorithmus Kammerflimmern, pulslose Ventr. Tachykardie

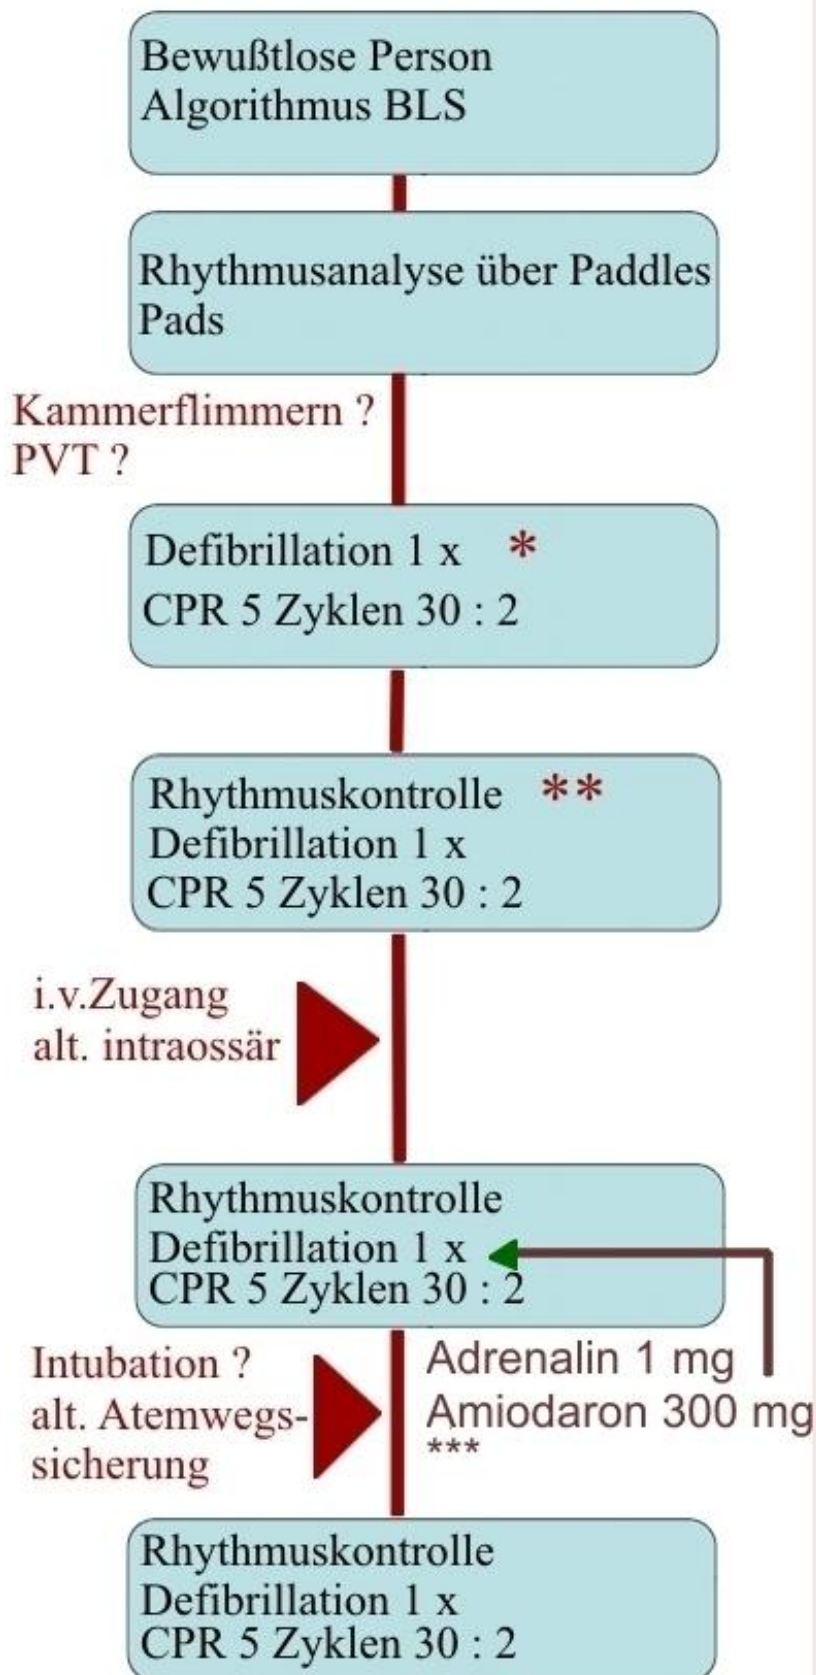

*
biphasisch
gerätespez. 150 - max
monophasisch 360

**
nur bei geordneter elektr.
Aktivität Pulskontrolle
bei sicher tastbarem Puls
weitere Stabilisierung

nach der 3. Defibrillation

während Reanimation:

Adrenalingabe alle 3 -5Minuten

möglichst ununterbrochene
Thoraxkompression

Suche reversibler Ursachen
= HITS (siehe unter)